



**SZPITALE
TCZEWSKIE SA**

OGŁOSZENIE

Odpowiedzi do zapytań, do postępowania 26/PN/2012

Dostawa Sprzętu i Materiałów Jednorazowego użytku

na potrzeby Zamawiającego

Z dnia: 31-10-2012r. (aktualizacja 2)

Nazwa (firma) Zamawiającego

SZPITALE TCZEWSKIE SPÓŁKA AKCYJNA

Adres Zamawiającego

UL. 30 STYCZNIA 57/58, 83-110 TCZEW. TEL. 58.777.66.73, FAX 58.531.38.30, www.szpitaletczewskiesa.pl

Pytanie 1

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 2

Czy zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 45 x 55 na podłożu mikroporowatym z żelcem stałym do badań holterowskich?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrody na podłożu mikroporowatym o wymiarach 43 x 45 z żelcem stałym?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą. Proponowane elektrody są multifunkcjonalne- mogą być więc wykorzystywane przy różnych typach badań EKG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści elektrody o wymiarach 32 x 38 na podłożu mikroporowatym?

Uzasadnienie: Materiał miroporowaty zapewnia znakomite przyleganie elektrod do skóry. Dzięki zwiększonej powierzchni klejącej elektrody- eliminowane jest ryzyko artefaktów, a co za tym idzie zapis sygnału EKG jest bardzo dobry- co jednoznacznie generuje oszczędności czasu oraz finansów. Elektrody na podłożu mikroporowatym są znacznie bardziej przyjazne dla skóry pacjenta, co przy długotrwałym badaniu jest także kwestią znaczącą. Proponowane elektrody są multifunkcjonalne- mogą być więc wykorzystywane przy różnych typach badań EKG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy: Pakiet 5 poz. 1, 2, 3, 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od dostarczenia próbek do Pakietu 5 poz. 1, 2, 3, 4_ ?

Uzasadnienie:

Przedmiotowa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XIII jako kryterium wyboru oferty uznaje cenę jako 100% wagi oceny, nie zawiera natomiast kryterium oceny jakości zamówienia poprzez badanie próbek. Dostarczenie próbek przez Wykonawcę uznaje się więc za bezcelowe z punktu widzenia procedury przetargowej.

Jeśli zamawiający bezwzględnie nie zamierza odstąpić od dostarczenia próbek, zobowiązany jest- na podstawie artykułu 91 ust 1 i 2 w związku z art. 36 ust. 1 pkt. 13 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Ustawa z dnia 29 stycznia

2004r. Dz. U. z 2010 Nr 113 poz. 759 (ze zm.) do zawarcia w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opisu kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował podczas wyboru oferty. Należy również wyjaśnić znaczenie wspomnianych kryteriów oraz sposób wyboru oferty. Kryteria te - w odniesieniu do próbek powinny bezwzględnie dotyczyć sposobu oceny jakości dostarczonych materiałów.

Ponadto zamawiający powinien określić: cel dostarczenia próbek, procedurę przeprowadzenia oceny jakości próbek w sposób nie naruszający zasad prowadzenia postępowania oraz określić sposób zapłaty za dostarczone próbki.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Próbki nie stanowią kryterium oceny ofert, zatem powoływanie się na zapisy Art. 91 ust. 1 i 2 w związku z Art. 36 ust. 1 pkt. 13 jest co najmniej niewłaściwe. Jedynym kryterium oceny ofert w przedmiotowym postępowaniu jest cena, co jasno wskazuje zapis części XIII SIWZ oraz zapis w ogłoszeniu o zamówieniu. Zamawiający zatem nie jest zobowiązany do wskazywania jakichkolwiek dodatkowych kryteriów, skoro jedyne kryterium, które przewidział to cena.

Żądanie dostarczenia próbek ma na celu potwierdzenie zgodności oferowanego asortymentu z wymogami SIWZ. Zamawiający w ten sposób zamierza zbadać czy próbki asortymentu odpowiadają wymaganiom określonym przez niego w SIWZ. Zgodnie z Art. 97, ust. 2 PZP Zamawiający zwróci Wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek złożone przez nich próbki.

Pytanie 5

Pakiet nr 5 poz. 1-2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 50 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Pytanie 6

Pakiet nr 5 poz. 3-4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie zmiany jednostki miary z sztuk na opakowania i odpowiednie przeliczenie ilości – 1 opakowanie = 30 sztuk w ww. pozycjach, których jednostką handlową są opakowania. Podanie cen za opakowania nie będzie zawyżało całkowitej wartości przygotowanej oferty przetargowej, co miałyby miejsce w przypadku przeliczenia ceny dla 1 sztuki i podania jej z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, co wiąże się z koniecznością jej zaokrąglenia.

Jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na powyższe prosimy o dopuszczenie możliwości podania ceny jednostkowej netto za jedną sztukę z dokładnością do 4 miejsc po przecinku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Pytanie 7

Pakiet nr 5 poz. 4

Jeśli Zamawiający wyrazi zgodę na przeliczenie wymaganych ilości na op. – 30 szt., prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować wówczas 534 op. po 30 szt. (zaokrąglenie do pełnych opakowań) czy 533,34 op. po 100 szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza cenę jednostkową za 1 szt. podaną z dokładnością do 4 miejsc po przecinku

Pytanie 8

Pakiet nr 5 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pozycji żelu do EKG o jasno-żółtym, przezroczystym kolorze, pozostałe parametry pozostaną bez zmian.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Projekt umowy - §1 ust. 4 /termin dostaw/
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę terminu dostaw na maks. 4 dni robocze.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 10

SIWZ – numery katalogowe oferowanych produktów
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości podania numerów stosowanych w programie sprzedażowym wykonawcy, które będą umieszczone również na fakturze, więc Zamawiający będzie mógł zweryfikować czy dostarczony Mu produkt odpowiada oferowanemu produktowi w ofercie przetargowej, w sytuacji gdy producent nie nadaje swoim produktom nr katalogowych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 11

Projekt umowy - §3 ust. 1 lit. c, d
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o zmianę kary umownej na 15% wartości brutto części umowy pozostałej do realizacji.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 12

Pakiet nr 6 poz. 6
Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. poz. papieru o rozm. 80 mm x 25 m /papier do EKG, z nadrukiem/, z jednoczesnym przeliczeniem wymaganych ilości tj. 432 rolki po 25 m.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 13

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 1-9
Uprzejmie prosimy o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga zaoferowania rękawów dwu wskaźnikowych (do pary wodnej, tlenu etylenu) czy też trzy wskaźnikowych (do pary wodnej, tlenu etylenu, formaldehydu).

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 14

Dotyczy wzoru umowy Par. 3 ust. 1, pkt c)
Uprzejmie prosimy o zmianę określonej we wzorze umowy wysokości kary za nieuzasadnione zerwanie umowy do 15% wartości brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Nieuzasadnione zerwanie umowy nie może mieć miejsca.

Pytanie 15

Pakiet 9 poz. 1
Czy Zamawiający dopuści preparat przeznaczony do chirurgicznego i higienicznego mycia rąk, sprawdzony dermatologicznie, chroniący i pielęgnujący skórę podczas mycia, odpowiedniego dla skóry wrażliwej i zniszczonej, bez barwników oraz mydła, o neutralnym pH dla skóry, z zawartością alantoiny chroniącej skórę przed podrażnieniami, zarejestrowany jako kosmetyk, w opakowaniach a 1l typu „soft airless” (system zamknięty) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

W razie wyrażenia zgody na ww. preparat prosimy o podanie liczby dozowników wymaganych przez Zamawiającego. Informujemy Zamawiającego, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dozowników określoną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 16

Pakiet 9 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego preparatu do wcierania, zawierającego etanol i bifenyl-2-ol, przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, czas dezynfekcji higienicznej 30sek., czas dezynfekcji chirurgicznej 1,5 min., o wyjątkowych zaletach w zakresie ochrony i pielęgnacji skóry dzięki sprawdzonym właściwościom natłuszczającym i nawilżającym, nie zawierającego barwników i substancji zapachowych, możliwość stosowania przez alergików, o skuteczności wobec: B (łącznie z Tbc), F, V (Polio, Rota, Adeno, Vaccinia, Herpes simplex, HBV, HCV, HIV, Noro, SARS), zarejestrowanego jako produkt biobójczy, w opakowaniach a 1l typu „soft airless” (system zamknięty) po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

W razie wyrażenia zgody na ww. preparat prosimy o podanie liczby dozowników wymaganych przez Zamawiającego. Informujemy Zamawiającego, że Wykonawca zapewni odpowiednią ilość dozowników określoną przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 17

Dotyczy Pakiet nr 7, pozycja nr 13:

Czy w miejsce wkładek absorpcyjnych 300mm x 500mm Zamawiający dopuści wkładki 305mm x 610mm w opakowaniu 1000sztuk? Wielkość zapotrzebowania zostanie odpowiednio przeliczona.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 7 parametry techniczne do pozycji nr 1-9:

Czy Zamawiający dopuści rękawy papierowo-foliowe o parametrach:

- (papier) wytrzymałość na przepuklenie na mokro 70 kPa,
- (papier) niezwilżalność wodą 28 sekund,
- (papier) wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1,6 kN/m, w kierunku poprzecznym 0,8 kN/m,

- (folia) zgrzewalna w temperaturze 165-190°C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 19

Pakiet 7 parametry techniczne do pozycji nr 1-9: Czy Zamawiający dopuści rękawy ze wskaźnikami sterylizacji parowej i tlenkiem etylenu bez wskaźnika procesu sterylizacji formaldehydowej ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Projekt umowy, zapis §1 pkt. 4a: Czy Zamawiający zechce wydłużyć termin dostawy do 5 dni?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 21

Projekt umowy, zapis §3 pkt. 1a i 1b: Czy Zamawiający zechce zmniejszyć wysokość kar umownych na 0,2% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku pierwszego opóźnienia i 0,5% niezrealizowanej części zamówienia za każdy dzień zwłoki w przypadku drugiego opóźnienia?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 22

Czy Zamawiający zechce przesunąć termin składania o dwa dni? Część przewoźników nie świadczy usług transportowych lub pełni tylko dyżury w dniu 02.11.2012 r.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 23

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wyłączenie rękawów papierowo-foliowych do sterylizacji (Lp. 1 - 9) oraz utworzenie odrębnego pakietu? Podzielenie pakietu umożliwiłoby większej ilości oferentom złożenie ofert atrakcyjnych pod względem ceny, walorów funkcjonalno-użytkowych oraz jakości. Umożliwienie złożenia ofert różnym firmom pozwoli Zamawiającemu na dokonanie wyboru oferty zgodnej z SIWZ i najkorzystniejszej cenowo.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 24

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy foliowo-papierowe o wytrzymałości na przedarcie w kierunku wytwarzania 650mN?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na sucho 350kPa.? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na sucho $\geq 400\text{kPa}$. Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednoczenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na przepuklenie na mokro 70kPa? Prosimy o obiektywne uzasadnienie wymogu Zamawiającego dotyczącego wytrzymałości na przepuklenie na mokro $\geq 150\text{ kPa}$ papieru służącego do produkcji rękawa do sterylizacji aż czterokrotnie przekraczającego wartość określoną normą PN EN 868-3, która wynosi $\geq 35\text{ kPa}$. Obowiązujące wymogi normatywne dla rękawów do sterylizacji zostały opracowane w celu wprowadzenia standaryzacji i ujednoczenia parametrów technicznych rękawów służących do sterylizacji używanych w placówkach służby zdrowia. Wszystkie dodatkowe zalety oferowanych rękawów czy wartości ponadnormatywne powinny być traktowane jako walor dodatkowy, nigdy zaś jako parametr graniczny.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o wytrzymałości na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania 1.3kN/m, w kierunku poprzecznym 0.7kN/m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe zgrzewalne w temperaturze 180-220°C?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o przenikalności powietrza $6,6 \mu/\text{Pa}\cdot\text{s}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe z folią o wytrzymałości na rozdarcie min. $379 \text{ Kg}/\text{cm}^2$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 31

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o niezwilżalności wodą 25s, z uwagi na wymagania normatywne, które wynoszą min. 20 sek.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 32

Dotyczy Pakietu 7:

Czy Zamawiający dopuści do oceny rękawy papierowo-foliowe o zgrzewie fabrycznym o wytrzymałości nie mniejszej niż $3,7 \text{ N}/15\text{mm}$?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 33

PAKIET NR 12

Poz. nr 1- Fartuch ochronny z włókniny

Poz. nr 4- Maska chirurgiczna

Poz. nr 5-6- Czepek chirurgiczny

Poz. nr 7- Ochraniacze na buty

Poz. nr 8-9- Podkłady nieprzemakalne

Poz. nr 10- Serweta zabiegowa

Poz. nr 15- Fartuch chirurgiczny

Poz. nr 17- Jednorazowe ubranie operacyjne


Poz. nr 19- Obłożenia do artroskopii kolana

Poz. nr 20- Obłożenia do artroskopii stawu barkowego

Poz. nr 23 – Osłona jałowa na przewody medyczne

zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wyłączenie w/w pozycji z Pakietu nr 12 i utworzenie z nich odrębnej części zamówienia z jednoczesnym dopuszczeniem możliwości zaoferowania:

- **Poz. nr 1-** fartucha w kolorze niebieskim, posiadającego mankiety zakończone lekko ściągającą gumką
- **Poz. nr 4** – maski medycznej jednorazowego użytku o wydajności w zakresie filtracji bakterii >98% Pozostałe parametry bez zmian.
- **Poz. nr 6-** czepka męskiego wykonanego z włókniny wiskozowej;
- **Poz. nr 7-** ochraniaczy na buty wykonanych z przewiewnej włókniny z antypoślizgową foliową aplikacją;
- **Poz. nr 9-** podkładu nieprzemakalnego w rozmiarze 60 x 90 cm;
- **Poz. nr 15-** Fartucha chirurgicznego zapinanego w okolicy karku na rzep (wiązany na troki w talii);
- **Poz. nr 15-** prosimy o sprecyzowanie jakiego rozmiaru fartucha oczekuje Zamawiający
- **Poz. nr 19-** obłożenia do artroskopii kolana o następującym składzie:

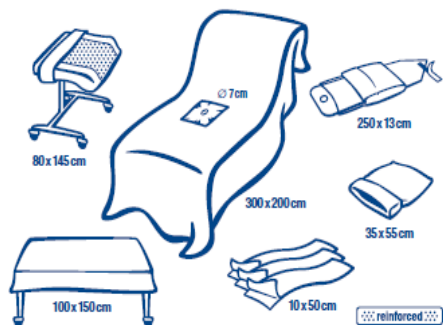


Zestaw do artroskopii II

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	100 x 150
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta na kończynę z elastycznym, samouszczelniającym się otworem (ø 7 cm)	300 x 200
1 osłona na kończynę	35 x 55
3 taśmy samoprzylepne	10 x 50
1 osłona na kamerę	13 x 250

- **Poz. nr 20-** obłożenia do artroskopii stawu barkowego o następującym składzie:

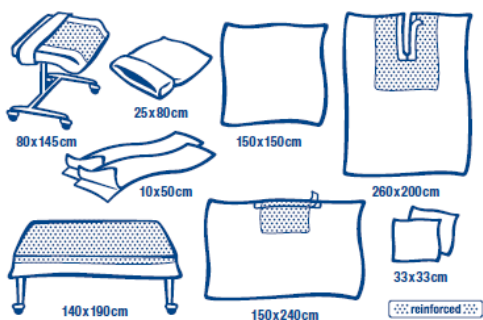

Zestaw do artroskopii stawu barkowego I wzmocniony

Skład zestawu:

1 serweta na stolik narzędziowy	140 x 190
1 obłożenie stolika Mayo	80 x 145
1 serweta samoprzylepna z wycięciem „U”	260 x 200
1 serweta pomocnicza	150 x 150
1 serweta samoprzylepna	150 x 240
1 osłona na kończynę	25 x 80
2 taśmy samoprzylepne	10 x 50
2 ręczniki celulozowe	33 x 33

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. Dla poz. 15 Zamawiający oczekuje fartucha o rozmiarach L i XL

Pytanie 34

PROJEKT UMOWY

§ 3, ust. 1 a- d- wnosimy o zmianę umowy przez obniżenie wysokości kar umownych, które w aktualnym brzmieniu stanowią kary rażąco wygórowane.

Wykonawca nie kwestionuje prawa zastrzeżenia przez zamawiającego kary umownej, jednakże jej wysokość musi pozostawać w prawidłowej proporcji do wysokości potencjalnej szkody jaką może on ponieść. Zgodnie bowiem z art. 484 §2 k.c. dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej w przypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana. "Rażąco wygórowanie" jako okoliczność uzasadniająca miarkowanie kary umownej musi być postrzegana jako porównanie rozmiaru poniesionej szkody w wyniku naruszenia zobowiązania w stosunku do wysokości zastrzeżonej kary umownej (B. Księżopolski, *Uwagi o miarkowaniu kar umownych w obrocie uspołecznionym*, PiP 1970, z. 3-4, s. 520). Kryterium oceny rażącego wygórowania może być także relacja jej wysokości do odszkodowania należnego wierzycielowi na zasadach ogólnych (P. Drapała, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97; P. Granecki, glosa do wyroku SN z 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2006, z. 1, poz. 2; K. Zagrobelny, glosa do wyroku SN z 23 marca 2006 r., IV CSK 89/05, OSP 2007, z. 6, poz. 66; wyrok SN z 20 maja 1980 r., I CR 229/80, OSNC 1980, nr 12, poz. 243; wyrok SN z 11 października 2007 r., IV CSK 181/07, OSNC-ZD 2008, nr 2, poz. 48). Ze stanem "rażącego wygórowania" mamy do czynienia, gdy dłużnik nie wykona zobowiązania lub wykonana je nienależycie, a wierzyciel nie poniesie szkody. W ocenie wnioskodawcy zaistnienie takiej sytuacji w przedmiotowej sprawie jest w pełni uzasadnione i zastrzeżenie tak wysokich kar umownych w przypadku kilkudniowego opóźnienia narusza zasady i cel zastrzegania kar umownych i w konsekwencji stanowi podstawę prawną i faktyczną zarzutu ich rażącego wygórowania. Wobec powyższego wnosimy o obniżenie wysokości kar umownych w zakresie:

- § 3, ust. 1 a do kwoty 0,2%,
- § 3, ust. 1 b do kwoty 0,2 %
- § 3, ust. 1 c-d do kwoty 10 % niezrealizowanej części umowy

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 35

Pakiet nr 1 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foley 2 – drożny o pojemności balonu:

- 3-5ml dla rozmiaru CH10
- 5-10ml dla rozmiaru CH12-CH24
- 30ml dla rozmiaru CH26 ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 36

Pakiet nr 1, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 8 z zadania 1 i utworzenie z niej odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 37

Pakiet nr 3 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje zestawu do lewatywy zakończonego miękkim drenem z otworem końcowym oraz dwoma naprzemianległymi otworami bocznymi?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 38

Pakiet nr 3 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści worek do godzinowej zbiórki moczu z filtrem hydrofobowym w komorze i zastawką w worku, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 39

Pakiet nr 3 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści woreczki do moczu dla dzieci w opakowaniu foliowym?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 40

Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji o długości min. 16,5cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 41

Pakiet nr 3 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści opaskę do identyfikacji o długości min. 25cm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 42

Pakiet nr 4

Czy Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych z wygrawerowaną na ostrzu nazwą producenta oraz rozmiarem ostrza?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje ostrzy chirurgicznych z wygrawerowanym na ostrzu przynajmniej rozmiarem

ostrza

Pytanie 43

Pakiet nr 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki niesterylne w opakowaniach a'80 szt. z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44

Pakiet nr 11, poz. 1-3, 10-13

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1-3, 10-13 z zadania 11 i utworzenie z nich odrębnego zadania? Podział zadania zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 45

Pakiet nr 11, poz. 4-6, 8

Czy zamawiający odstąpi od zapisu „nie zawierającego ftalanów” mając na uwadze stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie zastosowania polichlorku winylu w produkcji wyrobów medycznych :

„Wyroby medyczne zawierające PCV, nie powinny być obecnie wycofywane z rynku wyrobów medycznych. Nie wydaje się także, by – wobec umiarkowanego poziomu ryzyka stosowania tych wyrobów istniały przesłanki do ograniczenia stosowania takich wyrobów” – pismo do wglądu na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia. Pragniemy także poinformować, że informacją potwierdzającą bezpieczeństwo wyrobu medycznego są dokumenty tj. certyfikat CE, deklaracja zgodności. Odstąpienie od wymogu „nie zawierającego ftalanów” pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie znacznie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 46

Pakiet nr 12 poz. 4

Czy Zamawiający dopuści maskę chirurgiczną posiadającą integrowany sztywnik metalowy?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 47

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy o perforacji 38cm, dł. Całkowitej 50mb i szerokości 50cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48

Pakiet nr 12 poz. 13

Czy Zamawiający dopuści podkład dwuwarstwowy o perforacji 50cm, szerokości 60cm i długości całkowitej 40mb z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 49

Pakiet nr 12 poz. 14

Czy Zamawiający dopuści pokrowiec wykonany z polipropylenu?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 50

Pakiet nr 12 poz. 17

Czy Zamawiający dopuści ubranie operacyjne tylko w 1 kolorze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51

Pakiet nr 12 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 180cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta na kończynę (ręka, kolano) o wym. 200 x 300cm

Serweta z otworem samouszczelniającym się, otwór śr.3,5 cm. Serweta 3-warstwowa, z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym, z 2ma organizerami do mocowania przewodów. Gramatura serwety w polu niekrytycznym 75 g/m², odporność na przenikanie cieczy 180 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Serweta o wym.170 x 180cm

Serweta wykonana z włókniny, samoprzylepna.

1 x Taśma przylepna 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 40x40cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 52

Pakiet nr 12 poz. 19

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łatą chłonną/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody. Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Nogawica 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

4 x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53

Pakiet nr 12 poz. 20

Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet o składzie:

1 x Serweta na stolik instrumentariuszki o wym. 150 x 190cm

Serweta 2 - warstwowa, laminat i włóknina w części środkowej serwety, 1 warstwa laminatu w częściach bocznych, serweta stanowi drugie, wewnętrzne owinięcie zestawu. Gramatura serwety 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

1 x Serweta na stolik Mayo wzmocniona o wym. 80 x 140cm

Serweta w kształcie worka, wykonana z nieprzemakalnego laminatu z wzmocnieniem włókniną, składana teleskopowo, z

zaznaczeniem kierunku rozwijania serwety

1 x Serweta do artroskopii o wym. 200 x 320cm

Serweta z otworem elastycznym samouszczelniającym się o wym. 6 x 8cm. Serweta wykonana w polu niekrytycznym z włókniny z łata chłonna/wzmocnieniem w polu krytycznym o wym. min. 75 x50cm i 2oma organizerami na przewody.

Łata chłonna wykonana z włókniny i laminatu. Gramatura serwety w polu krytycznym 161 g/m², odporność na przenikanie cieczy 496 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na mokro 187 kPa.

1 x Torebka na płyny o wym. 60 x 100cm

Torebka z przezroczystego polietylenu, z otworem samouszczelniającym się o wym. 6x8cm, z kształtką metalową w górnej części torebki na całej jej górnej krawędzi, z 2ma przylepcami w przedniej części służące do ufixowania torebki, portem do odsysania treści w dolnej części worka, budowa końcówki portu umożliwi dopasowanie do nich drenów o różnej średnicy.

1 x Pokrowiec na przewody Comfort o wym. 14 x 250cm.

Pokrowiec z przezroczystego polietylenu, składany teleskopowo, z przylepcem

1 x Nogawica o wym. 30 x 60cm

Nogawica 2 - warstwowa. Gramatura 56 g/m², odporność na przenikanie cieczy 188 cm H₂O, wytrzymałość na rozrywanie na sucho 108 kPa.

2 x Taśma przylepna o wym. 10 x 50cm

2x Ręcznik do rąk o wym. 30x30 cm

Każdy zestaw posiada informację o dacie ważności i nr serii w postaci 2 naklejek typu TAG do wklejenia w karcie pacjenta. Produkt jest bezpiecznie pakowany do transportu i magazynowania - opakowanie typu TYVEC.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54

Pakiet nr 13 poz. 1, 2

Czy Zamawiający dopuści butelkę do odsysania dostosowaną do różnych średnic drenów od 6F-18F?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55

Pakiet nr 13 poz. 8-13

Czy Zamawiający dopuści dren Redona pakowany nie formie prostej tylko w formie zwiniętej?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 56

Pakiet nr 15 poz. 1-3

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczulenia z igłą prowadzącą o długości 34mm, spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 57

dot. Pakietu nr 12:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z pakietu nr 12 pozycji 15 (Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny) i utworzenie odrębnego pakietu, co pozwoli na złożenie ofert większej liczbie wykonawców?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 58

Dot. pakiet 8 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści kieliszki do podawania leków w opakowaniach 75 szt z odpowiednim przeliczeniem wymaganych ilości ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 59

Czy nastąpiła pomyłka w opisie przedmiotu zamówienia, ponieważ zagłębniki żołądkowe wyposażone w zatyczkę produkowane są do rozmiaru CH22, natomiast powyżej rozmiaru 22 tj. od CH24 do CH36 produkowane są bez

wbudowanej zatyczki. Jednakże ten sam producent oferuje zagłębniki o rozmiarach od CH24 do CH36 z dodatkową zatyczką (osobną) ale która jest jak najbardziej kompatybilna ze zagłębnikami w większych rozmiarach a różnią się minimalnie jedynie ceną od zagłębników w mniejszych rozmiarach. Czy w związku z tym Zamawiający dopuści takie zagłębniki od tego samego producenta?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zagłębniki żołądkowe z zatyczkami

Pytanie 60

Pakiet 7, pozycja 5 – prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 210 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61

Pakiet 7, pozycja 18 – prosimy o dopuszczenie rękawa o szerokości 250 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62

Pakiet 7, pozycja 14-20 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawów o długości rolki 70 m z odpowiednim przeliczeniem ceny w ofercie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z odpowiednim przeliczeniem ceny

Pytanie 63

Pakiet 7, pozycja 21 – prosimy o dopuszczenie opakowań typu SMS o gramaturze 43 g/m² o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 1)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.

Pytanie 64

Pakiet 7, pozycja 1-9 – prosimy o dopuszczenie rękawów o gramaturze papieru 60g/m², o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 2), pozostałe parametry zgodne ze SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.

Pytanie 65

Pakiet 7, pozycja 10-11 prosimy o dopuszczenie papieru o parametrach: - wytrzymałość na rozciąganie liniowe na makro w kierunku walcowania nie mniej niż 0,8 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,5 kN/m, pozostałe zapisy jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Pakiet 7, pozycja 12 – prosimy dopuszczenie włókniny, która posiada wytrzymałość na rozdarcie 1250 mN, pozostałe parametry jak w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

Pakiet 7, pozycja 14-20 prosimy o dopuszczenie rękawów o gramaturze 74g/m² o parametrach jak na załączonej karcie charakterystyki (zał. Nr 3)

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje sformułowania pytania w sposób jednoznaczny, zapewniający zachowanie zasad konkurencji, którego treść będzie możliwa do opublikowania. Zamawiający nie akceptuje dołączania do pytań załączników, których zeskanowanie wiąże się z ujawnieniem danych Wykonawcy zadającego pytanie, w związku z umieszczonymi pieczęciami Wykonawcy. Ponadto załączniki są nieczytelne.

Pytanie 68

Dotyczy pakietu nr 15:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie w pak. 15 poz.1 igieł do znieczulania podpajeczynówkowego z igłą prowadzącą 22Ga/30 mm, w poz. 2 z igłą prowadzącą 21Ga/30 mm, w poz. 3 z igłą prowadzącą 21Ga/30mm, pozostałe parametry bez zmian?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 69

Prosimy o wydłużenie czasu realizacji zamówień do 3 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 70

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania produktów, które w momencie dostawy będą miały przynajmniej 2/3 terminu ważności oferowanego przez producenta.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ. W zapisach SIWZ kwestia ta jest dokładnie wytłumaczona

Pytanie 71

Prosimy Zamawiającego o ujednoczenie kar umownych określonych w §3 ust. 1 pkt a) i b) wzoru umowy do wysokości 0,2% wartości niezrealizowanego w terminie zamówienia za każdy dzień zwłoki. Kary w wysokości określonej przez Zamawiającego są rażąco wysokie. Należy nadmienić, że wykonawca dołoży wszelkich starań aby dostawy realizowane były terminowo.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 72

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 1 pkt c) wzoru umowy na następujący:

„nieuzasadnionego zerwania niniejszej umowy, przez co strony rozumieją w szczególności zaprzestanie przez Wykonawcę sprzedaży i dostarczania Produktów (nie dotyczy sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zalegania przez Zamawiającego z płatnościami powyżej 30 dni) lub wykonywania innych obowiązków wynikających z postanowień niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną w wysokości 15 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy.”

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 73

Zwracamy się z prośbą o zmianę §3 ust. 3 wzoru umowy na następujący:

„Naliczenie przez Zamawiającego kary umownej następuje przez sporządzenie noty księgowej wraz z pisemnym uzasadnieniem oraz terminem zapłaty.”

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 74

Prosimy Zamawiającego o modyfikację §4 ust. 2 wzoru umowy w następujący sposób: Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie

umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 75

Prosimy o wykreślenie §7 ust. 1 wzoru umowy.

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 76

Pakiet 15, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynowego pencil-point G27x88 mm, z igłą prowadzącą G20x35mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 77

Pakiet 15, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igłę do znieczulenia podpajęczynowego pencil-point G25x88 mm, z igłą prowadzącą G22x35mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 78

Pakiet 15, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści zamiennie igłę do znieczulenia podpajęczynowego ze szlifem atraumatycznym typu „Atraucan” G26x88 mm, z igłą prowadzącą G20x35mm?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 79

Pakiet 15, poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje, aby dla igieł do znieczulenia podpajęczynowego ze szlifem pencil-point prowadnica skracająca długość roboczą igły nie więcej, niż o 12mm? jest to szczególnie ważne przy pacjentach otyłych, gdzie długość igły ma zasadnicze znaczenie, a jak wynika z SIWZ Zamawiający nie przewiduje zakupu igieł o długościach większych (np. 120-150mm)

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 80

Pakiet 15, poz. 1-3

Czy Zamawiający oczekuje, aby dla igieł do znieczulenia podpajęczynowego ze szlifem pencil-point możliwa była natychmiastowa i bardzo wyraźna obserwacja wypływu PMR z każdej strony, dzięki zastosowaniu pryzmatycznego elementu powiększającego umieszczonego w owalnym, ergonomicznym uchwycie?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 81

Pakiet 16, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie zestaw zawierający:

- Igła ze szlifem Touhy G16 lub G18
- cewnik odpowiednio G19 lub G20 x 1000mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty z **atraumatyczną**, wyraźnie wyczuwalną **miękką końcówką** - trzy otwory boczne,
- podłużny łącznik zatraskowy do cewnika
- tulejka ułatwiająca wprowadzenie cewnika do igły
- filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7bar
- posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta (okrągły plaster z zatraskiem)
- strzykawka niskooporowa LOR 10ml, luer, ze skalą odróżniającą ją od innych strzykawek
- system mocowania cewnika do skóry pacjenta z opatrunkiem - całkowicie płaski, bez żadnych wystających elementów mogących spowodować przypadkowe wysunięcie cewnika z przestrzeni zewnątrzoponowej podczas ruchów pacjenta, z możliwością wymiany opatrunku bez zdejmowania mocowania samego cewnika

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 82

Pakiet 16, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zamiennie zestaw zawierający:

- cewniki kontrastujący w promieniach RTG
- strzykawka 5ml (trzyczęściowa)
- skalpel
- igła 1,3 (18G) x 70 mm
- możliwość identyfikacji cewnika za pomocą EKG
- cewnik wykonany z poliuretanu, atraumatyczny koniec cewnika
- prowadnica metalowa J o długości 50 cm
- rozszerzadło z tworzywa sztucznego F8 dopasowane do każdego rozmiaru cewnika
- znaczniki do kontroli położenia cewnika
- zaciski do krótkotrwałych przerw w infuzji
- klips mocujący
- skrzydełko mocujące przesuwne i stałe
- przezroczyste końcówki lock

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 83

Pakiet 16, poz. 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby introducer (igła) posiadał możliwość wprowadzenia prowadnika bez konieczności odłączania strzykawki aspiracyjnej, zapobiegając w ten sposób ryzyku ewentualnego zakażenia oraz zatorowości powietrza?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 84

Pakiet 16, poz. 2:

Czy Zamawiający oczekuje, aby prowadnice wykonane były z odpornego na odkształcenia metalu (stop z domieszką tytanu) pozwalającego na poprawne wprowadzenie nawet w przypadku zagięcia prowadnika w naczyniu (co nie jest możliwe w przypadku klasycznych prowadników)?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 85

Pakiet 16, poz. 3:

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 3, tworząc odrębny pakiet na ten produkt, umożliwiając tym samym możliwość

uzyskania bardziej konkurencyjnych ofert na pozycje 1-2?

Odpowiedź: Postępować zgodnie ze SIWZ

Pytanie 86

Pakiet 16, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści prowadnik J 035" x 45 cm zamiast 140 cm? pozostałe parametry bez zmian

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje prowadnika J035" x 40 cm